



Liebherr Gerät LCv 4010 – Auswertung Kühlteil

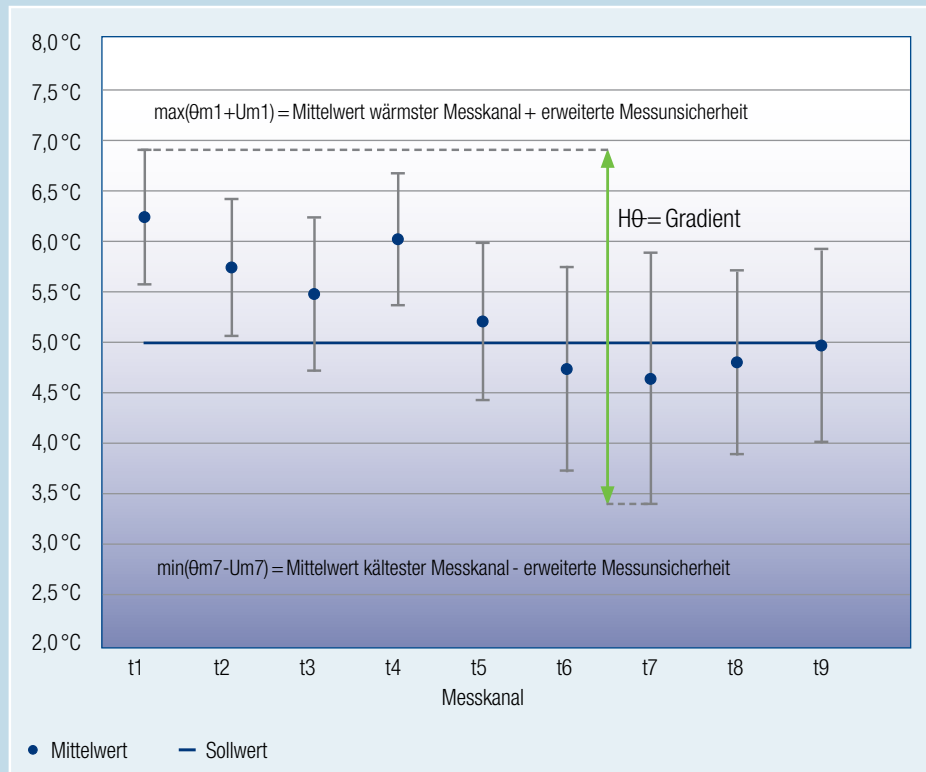

Gradient H $\theta$ : **3.4K** (+1.8K / -1.6K Abweichung von der eingestellten Temperatur)

Max. Fluktuation: **4.0K**

Liebherr Gerät LCv 4010 – Auswertung Gefriereteil

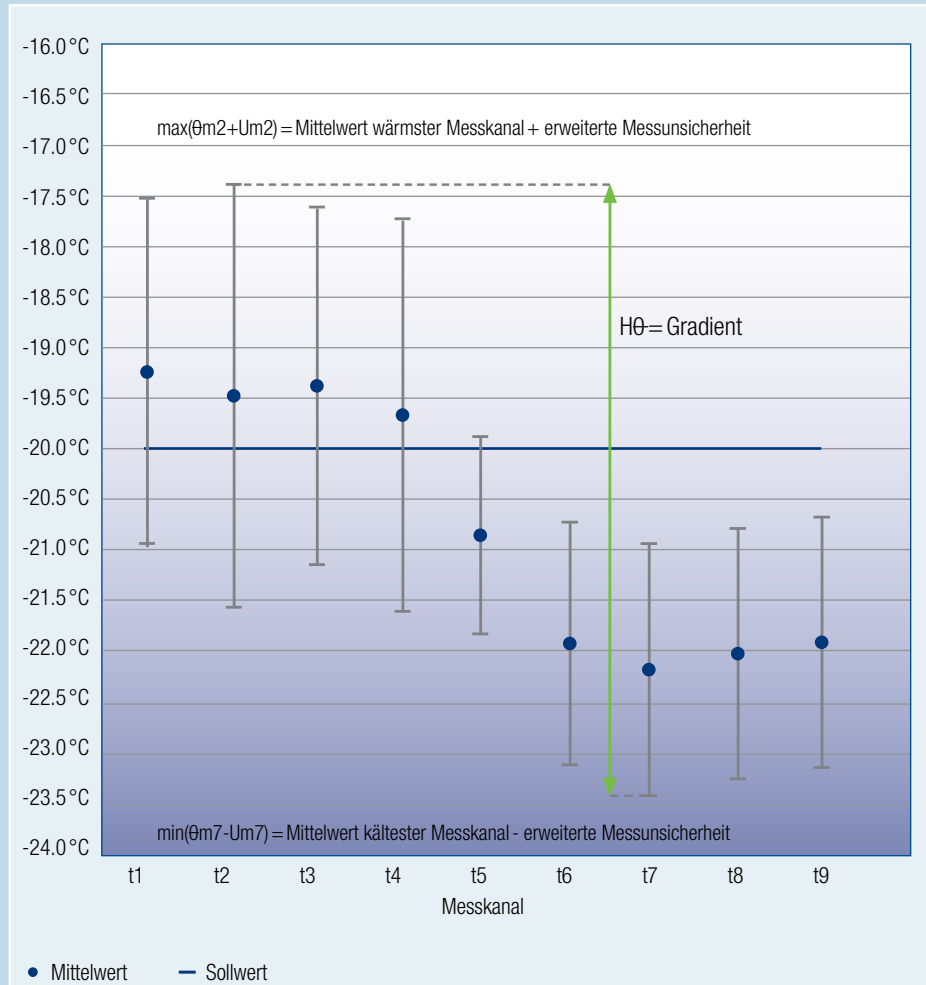

Gradient H $\theta$ : **6.0K** (+2.6K / -3.4 K Abweichung von der eingestellten Temperatur)

Max. Fluktuation: **3.4K**